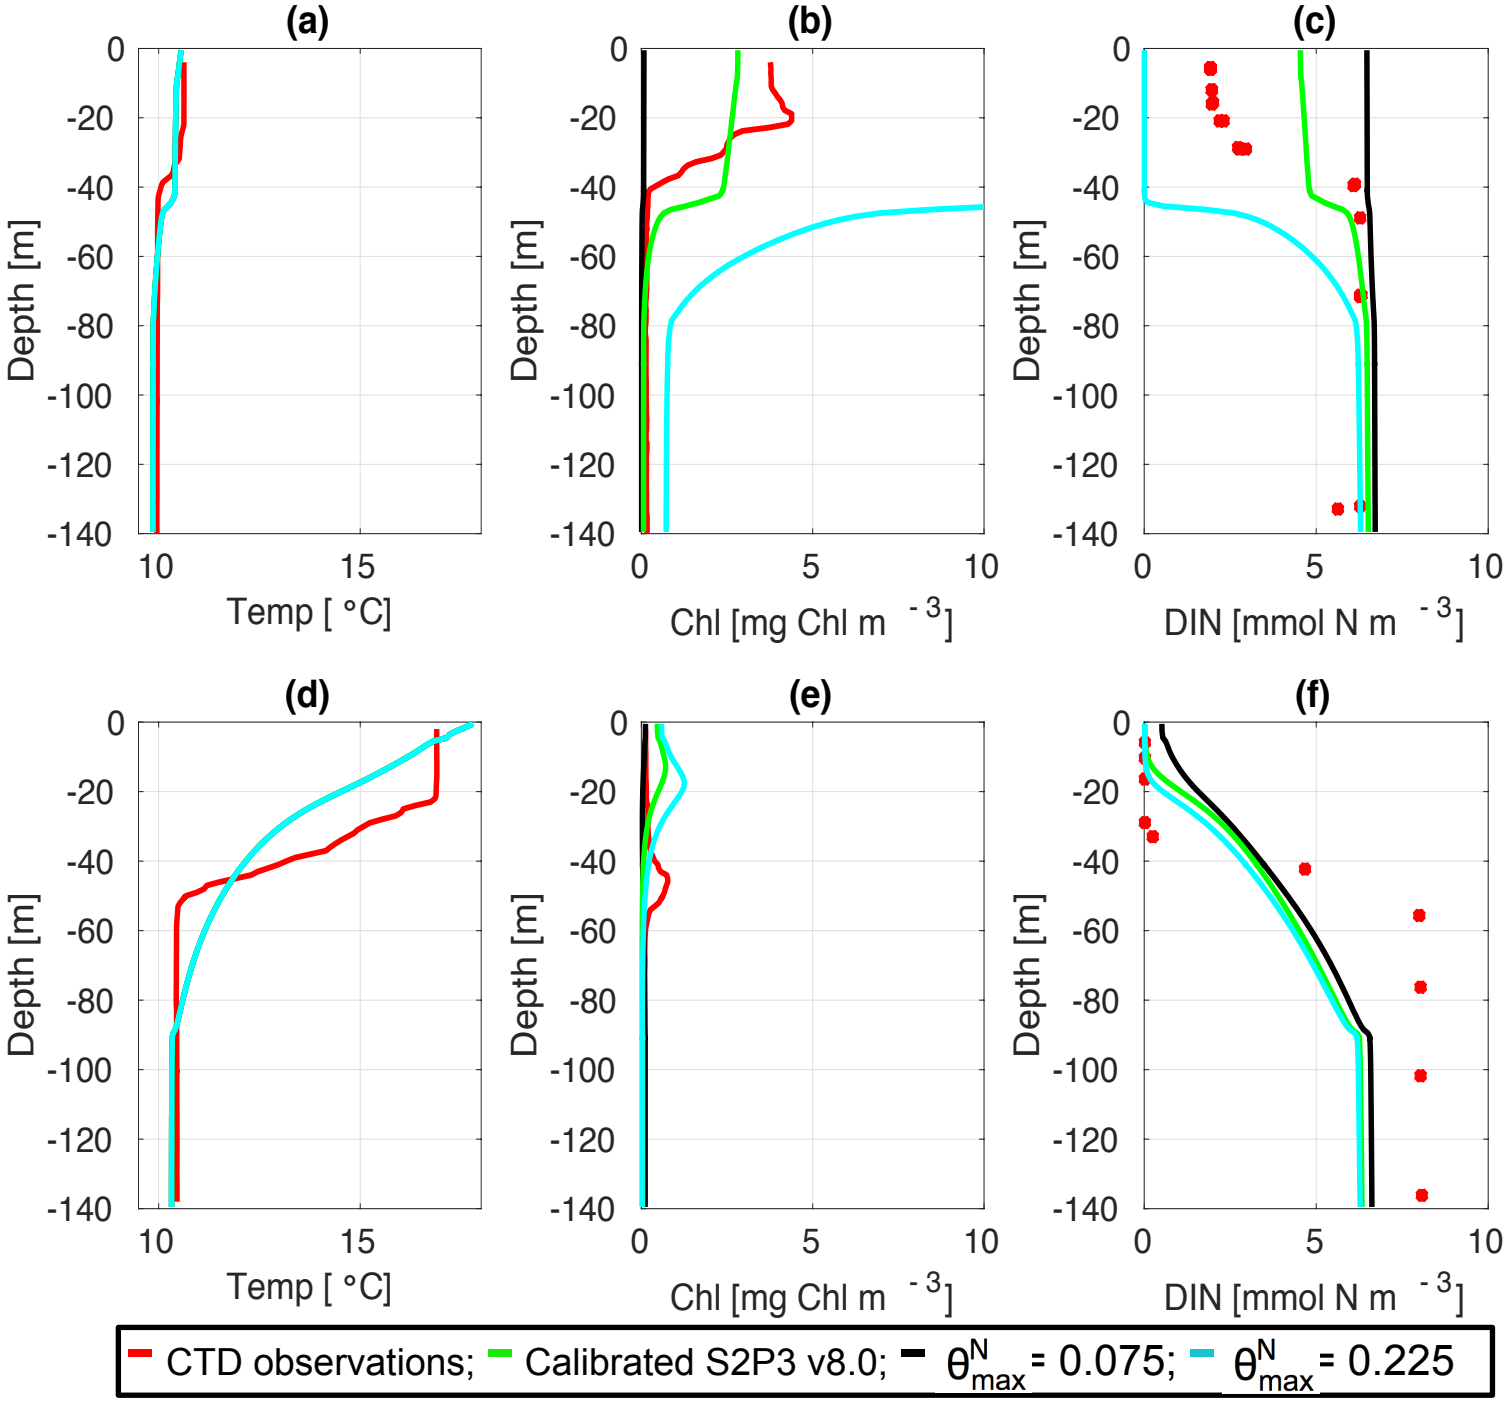
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
Depth [m]
Temp [°C]
Chl [mg Chl m - 3]
DIN [mmol N m - 3]
CTD observations; Calibrated S2P3 v8.0; θ^N_{max} = 0.075; θ^N_{max} = 0.225